



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОГО
РАСХОДА ГАЗА В ДИАПАЗОНЕ

$4 \cdot 10^{-2} \div 2,5 \cdot 10^2$ кг / с

ГОСТ 8.369-79

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ**

А. П. Герасимов, канд. техн. наук (руководитель темы); А. В. Ахманов;
В. М. Красавин, канд. техн. наук; О. К. Семенова, В. В. Чванов

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Зам. председателя В. И. Кипаренко

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-
ного комитета СССР по стандартам от 27 декабря 1979 г. № 5083**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Государственная система обеспечения единства
измерений

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОГО РАСХОДА
ГАЗА В ДИАПАЗОНЕ $4 \cdot 10^{-2} \div 2,5 \cdot 10^2$ кг/с**

State system for ensuring the uniformity of measurements. State primary standard and all-union verification schedule for means measuring mass flow of gas within the range of $4 \cdot 10^{-2} \div 2,5 \cdot 10^2$ kg/sec

**ГОСТ
8.369—79**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 декабря 1979 г. № 5083 срок введения установлен

с 01.01 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный первичный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств измерений массового расхода газа в диапазоне $4 \cdot 10^{-2} \div 2,5 \cdot 10^2$ кг/с и устанавливает назначение государственного первичного эталона единицы массового расхода газа в диапазоне $4 \cdot 10^{-2} \div 4 \cdot 10^{-1}$ кг/с — килограмма в секунду (кг/с), комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические параметры эталона и порядок передачи размера единицы массового расхода газа от первичного эталона при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный первичный эталон

1.1.1. Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы массового расхода газа в диапазоне $4 \cdot 10^{-2} \div 4 \cdot 10^{-1}$ кг/с и передачи размера единицы при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве СССР с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений массового расхода газа в диапазоне $4 \cdot 10^{-2} \div 2,5 \cdot 10^2$ кг/с, выполняемых в СССР, должна быть положена единица, воспроизводимая указанным государственным эталоном.



1.1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:

система подготовки и воспроизведения потока газа;

набор эталонных сопел;

аппаратура для измерений количества газа в единицах массы;

аппаратура для измерений интервала усреднения;

испытательный участок;

пульт управления.

1.1.4. Диапазон значений массового расхода газа, воспроизведенных эталоном, составляет $4 \cdot 10^{-2} \div 4 \cdot 10^{-1}$ кг/с.

1.1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы со средним квадратическим отклонением результата измерений (S_0), не превышающим $5 \cdot 10^{-4}$, при неисключенной систематической погрешности (Θ_0), не превышающей $5 \cdot 10^{-4}$.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы массового расхода газа в диапазоне $4 \cdot 10^{-2} \div 4 \cdot 10^{-1}$ кг/с с указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный первичный эталон применяют для передачи размера единицы массового расхода газа рабочим эталонам сличием при помощи компаратора (набора эталонных сопел).

1.2. Вторичные эталоны

1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют комплексы следующих средств измерений:

система подготовки и воспроизведения потока газа, набор эталонных сопел, аппаратура для измерений количества газа в единицах массы, аппаратура для измерений интервала усреднения, испытательный участок, пульт управления.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результата поверки рабочих эталонов не должны превышать $5,2 \cdot 10^{-4}$.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размера единицы массового расхода газа образцовым и рабочим средствам измерений высокой точности непосредственным сличием.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Образцовые средства измерений, заимствованные из других поверочных схем

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствованных из других поверочных схем, применяют образцовые грузо-поршневые манометры 1-го разряда, образцовые гири 2-го разряда, образцовые весы 2-го разряда, образцовые электронно-счетные частотометры, образцовые термометры 1-го разряда и образцовые металлические мерники 1-го разряда.

2.1.2. Образцовые средства измерений, заимствованные из других поверочных схем, применяют для аттестации образцовых средств измерений 2-го разряда методом косвенных измерений.

2.2. Образцовые средства измерений 1-го разряда

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда применяют наборы образцовых критических расходомеров и образцовые дифференциальные критические расходомеры.

2.2.2. Средние квадратические отклонения результата поверки образцовых средств измерений 1-го разряда составляют от $6 \cdot 10^{-4}$ до $10 \cdot 10^{-4}$ при неисключенных систематических погрешностях, составляющих от $5 \cdot 10^{-4}$ до $15 \cdot 10^{-4}$.

2.2.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда и рабочих средств измерений непосредственным сличением.

2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда применяют наборы образцовых критических расходомеров, наборы образцовых расходомеров и поверочные установки.

2.3.2. Средние квадратические отклонения результата поверки образцовых расходомеров 2-го разряда составляют от $7 \cdot 10^{-4}$ до $15 \cdot 10^{-4}$ при неисключенных систематических погрешностях, составляющих от $5 \cdot 10^{-4}$ до $15 \cdot 10^{-4}$.

Пределы допускаемых относительных погрешностей (δ_0) поверочных установок 2-го разряда составляют от 0,5 до 1,5 %.

2.3.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений непосредственным сличением.

2.3.4. Соотношение погрешностей образцовых средств измерений 1 и 2-го разрядов должно быть не более 1:1,15.


3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют расходомеры газа.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабочих средств измерений составляют от 0,5 до 5 %.

3.3. Соотношение пределов погрешностей образцовых 2-го разряда и рабочих средств измерений должно быть не более 1:3.

Общесоюзная поверочная схема для средств измерений массового расхода газа в диапазоне $4 \cdot 10^{-2} \div 2,5 \cdot 10^2 \text{ кг/с}$

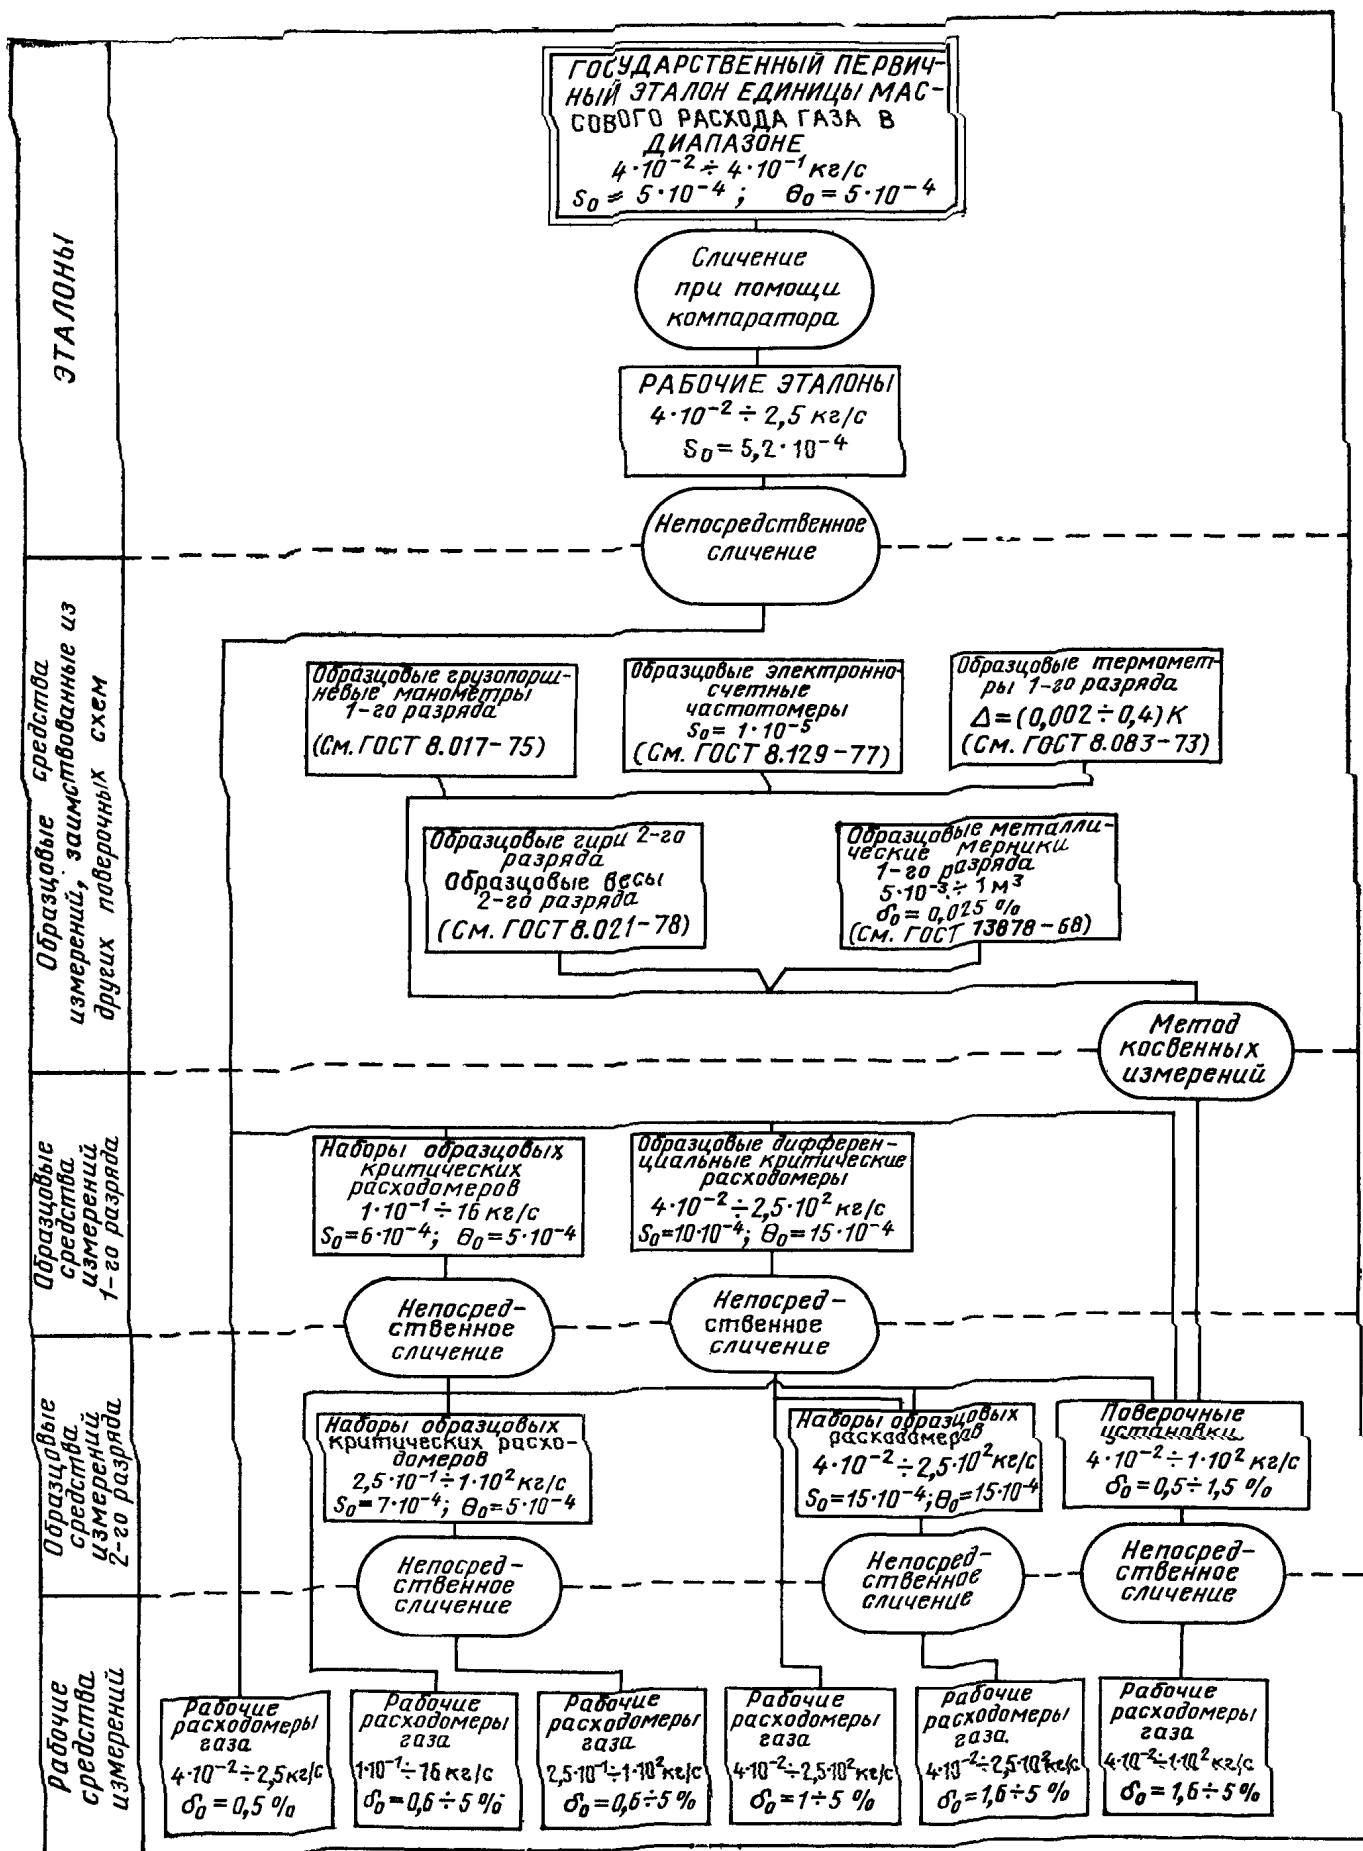

Редактор *Л. А. Бурмистрова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб 09 01 80 Подп к печ 14 03 80 0,375 п л +вкл 0,125 п л
0,37 уч -изд л +вкл 0,16 уч -изд л Тир 16000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6 Зак 145

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		русское	международное
ДЛИНА	метр	м	м
МАССА	килограмм	кг	kg
ВРЕМЯ	секунда	с	s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА	ампер	А	A
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ			
ТЕМПЕРАТУРА	кельвин	К	K
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА	моль	моль	mol
СИЛА СВЕТА	кандela	кд	cd
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Плоский угол	радиан	рад	rad
Телесный угол	стерадиан	ср	sr

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица		Выражение производной единицы	
	наименование	обозначение	через другие единицы СИ	через основные единицы СИ
Частота	герц	Гц	—	с^{-1}
Сила	ニュтона	Н	—	$\text{м кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Давление	паскаль	Па	$\text{Н} / \text{м}^2$	$\text{м}^{-1} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Энергия, работа, количество теплоты	дюйль	Дж	$\text{Н} \cdot \text{м}$	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Мощность, поток энергии	ватт	Вт	$\text{Дж} / \text{с}$	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3}$
Количество электричества, электрический заряд	кулон	Кл	$\text{А} \cdot \text{с}$	$\text{с} \cdot \text{А}$
Электрическое напряжение, электрический потенциал	вольт	В	$\text{Вт} / \text{А}$	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	Ф	$\text{Кл} / \text{В}$	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^4 \cdot \text{А}^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ом	$\text{В} / \text{А}$	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	См	$\text{А} / \text{В}$	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^3 \cdot \text{А}^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Вб	$\text{В} \cdot \text{с}$	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	Тл	$\text{Вб} / \text{м}^2$	$\text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$
Индуктивность	генри	Гн	$\text{Вб} / \text{А}$	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-2}$
Световой поток	люмен	Лм	—	$\text{кд} \cdot \text{ср}$
Освещенность	люкс	Лк	—	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кд} \cdot \text{ср}$
Активность нуклида	беккерель	Бк	—	с^{-1}
Доза излучения	грей	Гр	—	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$

* В эти два выражения входит, наравне с основными единицами СИ, дополнительная единица — стерадиан.