

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
8.612—  
2011

---

**Государственная система обеспечения  
единства измерений**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА  
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ  
ПЛОТНОСТИ ПОКРЫТИЙ В ДИАПАЗОНЕ  
ОТ 0,0001 ДО 1,000 КГ/М<sup>2</sup>**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

### Сведения о стандарте

- 1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)
- 2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1077-ст
- 4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 8.612—2005

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а тексты изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ПОКРЫТИЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,0001 ДО 1,000 КГ/М<sup>2</sup>

State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for means of measuring the surface density of coating in the range from 0,0001 to 1,000 kg/m<sup>2</sup>

Дата введения — 2013—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерений поверхности плотности металлических и неметаллических неорганических покрытий в диапазоне от 0,0001 до 1,000 кг/м<sup>2</sup> [рисунок А.1 (приложение А)] и устанавливает порядок передачи единицы<sup>1)</sup> поверхности плотности покрытий — килограмма на квадратный метр (кг/м<sup>2</sup>) от государственного первичного специального эталона единицы поверхности плотности покрытий (далее — государственный первичный специальный эталон) с помощью рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.021—2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массы

ГОСТ 18061—90 Толщиномеры радиоизотопные. Общие технические условия

**П р и м е ч а н и е** — При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при использовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

**3 Государственный первичный специальный эталон**

3.1 Государственный первичный специальный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы поверхности плотности покрытий и передачи единицы с помощью рабочих эталонов рабочим средствам измерений в целях обеспечения единства измерений в стране.

3.2 В основу измерений поверхности плотности покрытий должна быть положена единица, воспроизводимая указанным эталоном.

<sup>1)</sup> Передача единицы поверхности плотности покрытий с помощью эталонов 1-го и 2-го разрядов осуществляется при поверке, калибровке, испытаниях средств измерений и аттестации методик (методов) измерений.

3.3 Государственный первичный специальный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:

- рентгеновский преобразователь, содержащий Si-PIN-детектор, источник гамма-излучения с максимальной энергией 165 нДж и источник рентгеновского излучения с максимальной энергией 34 нДж (блок № 1);
- бета-преобразователь, содержащий четыре счетчика СИ-15БГ и бета-источник на основе радионуклида с максимальной энергией 1,4 нДж (блок № 2);
- бета-преобразователь, содержащий восемь счетчиков СБМ-20; бета-источник на основе радионуклидов с максимальной энергией 14 нДж (блок № 3);
- рентгеновский преобразователь, содержащий Si-PIN-детектор, рентгеновскую трубку с высоковольтным источником напряжения (блок № 4) и системой вакуумирования измерительной камеры;
- эталоны 1-го разряда (в соответствии с рекомендациями по метрологии [1]) в виде наборов металлических пленок в диапазоне от  $1 \cdot 10^{-2}$  до 1,000 кг/м<sup>2</sup> и относительной погрешностью от 0,2 % до 0,3 % и наборов металлических покрытий на металлических и неметаллических основаниях в диапазоне от  $1 \cdot 10^{-4}$  до  $1 \cdot 10^{-2}$  кг/м<sup>2</sup> и относительной погрешностью от 0,3 % до 2,0 %;
- процессор спектрометрических импульсов;
- ПЭВМ с программным обеспечением.

3.4 Диапазон значений поверхностной плотности покрытий, воспроизводимых государственным первичным специальным эталоном, составляет от  $1 \cdot 10^{-4}$  до 1,000 кг/м<sup>2</sup>.

3.5 Государственный первичный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы поверхностной плотности покрытий со следующими показателями точности:

- среднее квадратическое отклонение результата измерений  $S_0$  от  $0,5 \cdot 10^{-2}$  до  $1,0 \cdot 10^{-2}$  при проведении десяти независимых измерений в зависимости от диапазона измерений;
- неисключенная систематическая погрешность  $\theta_0$  от  $0,3 \cdot 10^{-2}$  до  $2,0 \cdot 10^{-2}$  в зависимости от диапазона измерений (при доверительной вероятности  $P = 0,95$ );
- стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А,  $u_{A0}$  от  $0,5 \cdot 10^{-2}$  до  $1,0 \cdot 10^{-2}$  в зависимости от диапазона измерений при проведении десяти независимых измерений;
- стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В,  $u_{B0}$  от  $0,2 \cdot 10^{-2}$  до  $1,0 \cdot 10^{-2}$  в зависимости от диапазона измерений.

3.6 Государственный первичный специальный эталон применяют в целях:

- установления эквивалентности эталонов национальных метрологических институтов (НМИ) стран, подписавших договоренность [2] о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых НМИ, в рамках международных сличений;
- передачи единицы поверхностной плотности покрытий рабочим эталонам 1-го и 2-го разрядов методом прямых измерений.

## 4 Рабочие эталоны

### 4.1 Эталоны, заимствованные из других поверочных схем

4.1.1 В качестве эталонов, заимствованных из других поверочных схем, используют гири 1-го разряда по ГОСТ 8.021 с диапазоном от  $1 \cdot 10^{-6}$  до 1,0 кг и штриховые меры длины 2-го разряда в соответствии с рекомендациями по метрологии [3] до 1000 мм.

П р и м е ч а н и е — Приведенное на рисунке А.1 обозначение  $L$  — геометрический размер участка, занимаемый покрытием, мкм.

4.1.2 Гири 1-го разряда и штриховые меры длины 2-го разряда применяют для передачи единицы поверхностной плотности покрытий эталонам 2-го разряда методом косвенных измерений.

На рисунке А.1 приведено обозначение  $\delta$  — это абсолютная погрешность, которая для гирь указана в граммах, а для штриховой меры длины в мкм.

### 4.2 Рабочие эталоны 1-го разряда

4.2.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда используют стандартные образцы поверхностной плотности покрытий в диапазоне измерений от  $1 \cdot 10^{-4}$  до 1,000 кг/м<sup>2</sup>.

4.2.2 Доверительные границы относительной погрешности рабочих эталонов 1-го разряда  $\delta_0$  при доверительной вероятности 0,95 составляют от 1,0 % до 5,0 %.

4.2.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единицы поверхностной плотности покрытий рабочим средствам измерений методом прямых измерений.

#### 4.3 Рабочие эталоны 2-го разряда

4.3.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда используют стандартные образцы поверхностной плотности покрытий в диапазоне от  $1 \cdot 10^{-4}$  до  $1,000 \text{ кг}/\text{м}^2$ .

4.3.2 Доверительные границы относительной погрешности  $\delta_0$  рабочих эталонов 2-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 2,5 % до 10 %.

4.3.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единицы поверхностной плотности покрытий рабочим средствам измерений методом прямых измерений.

### 5 Рабочие средства измерений


5.1 В качестве рабочих средств измерений используют:

- измерительные системы и измерители поверхностной плотности покрытий;
- радиоизотопные толщиномеры покрытий по ГОСТ 18061.

5.2 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности  $\Delta_0$  рабочих средств измерений составляют от 2 % до 20 %.

ГЛАВА IV

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

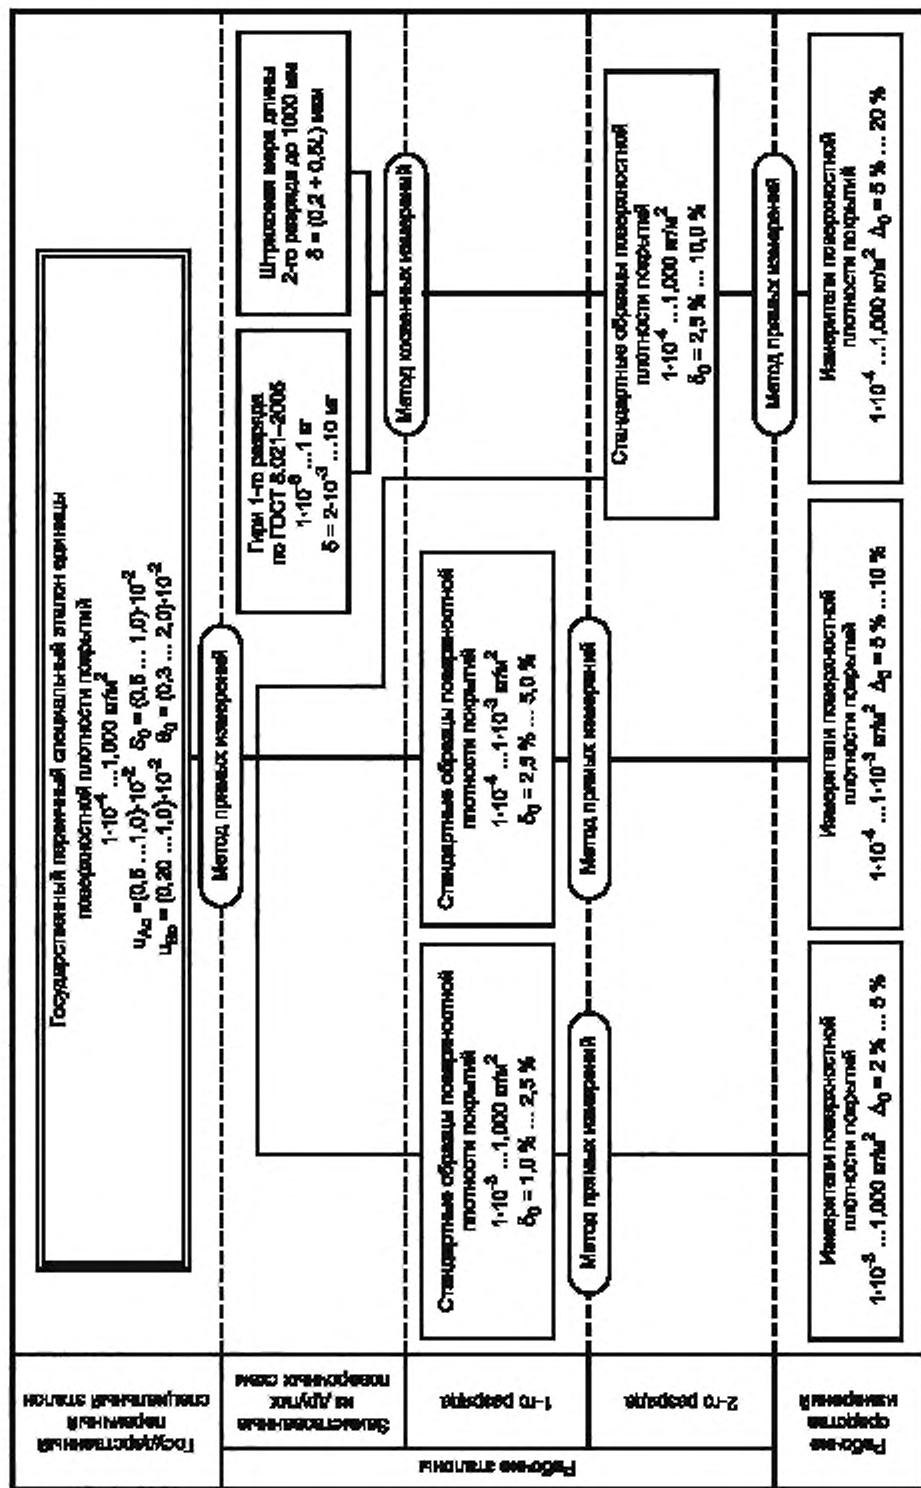

## Библиография

- [1] Рекомендации по метрологии МИ 2123—90 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности и толщины листовых и ленточных материалов
- [2] Договоренность о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами, г. Париж, 14 октября 1999 г.
- [3] Рекомендации по метрологии Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне  $1 \cdot 10^{-8} \dots 50$  м и длин волн в диапазоне  $0,2 \dots 50$  мкм

УДК 389.14.089.6:006.354

ОКС 17.020

T84.2

Ключевые слова: государственная поверочная схема, эталон, средство измерений, поверхностная плотность, покрытие, передача единицы, поверка, калибровка, испытания

---

Редактор *Л.В. Афанасенко*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *Ю.М. Прохорьева*

Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 17.12.2013. Подписано в печать 16.01.2014. Формат 60 × 84 ½. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,74. Тираж 98 экз. Зак. 45.

---

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)